

# 苏州龙测检测技术服务有限公司

Suzhou Longce Testing Technology Service Co., Ltd.

## 检测报告

Test Report

检测项目: 异丙醇、酒精、过氧化氢溶液  
擦拭试验

样品名称: 半自动体外除颤器

委托单位: 久心医疗科技(苏州)有限公司

检验类别: 委托检测

编制: 汪飞 校核: 陈林春 审批: 陆继田  
授权签字人

## 1、试验信息

样品名称	半自动体外除颤器
规格型号/机种号	iAED-S2PC, iAED-S2PE, iAED-S2HC, iAED-S2HE
样品数量	4 件
样品编号	LCJC2022092100203~06 (简写为 1#~4#)
委托单位名称	久心医疗科技(苏州)有限公司
委托单位地址	江苏省苏州市苏州工业园区星湖街 218 号生物纳米园 B2 楼 303 室
制造单位名称	久心医疗科技(苏州)有限公司
制造单位地址	江苏省苏州市苏州工业园区星湖街 218 号生物纳米园 B2 楼 303 室
送样人员信息	/
样品状态	符合试验要求
收样日期	2022-09-21
检验日期	2022-09-22~2022-10-11
检测依据	1. 委托检测合同单; 2. 委托方要求。
检测人员	汪飞
检测室温度	25±5℃
检测室湿度	50±5%RH

## 2、试验项目和结果

序号	试验项目	试验条件	检测结果
1	异丙醇，酒精，过氧化氢溶液擦拭试验	使用 70%浓度异丙醇溶液，75%浓度酒精溶液，3%浓度过氧化氢溶液擦拭样品表面。	<p>试验前，后，检查外观、结构完好，性能正常。</p> <p>性能判断要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 儿童 50J 能量满足 <math>50J \pm 10\%</math> 要求；</li> <li>2) 成人 150J 能量满足 <math>150J \pm 10\%</math> 要求</li> <li>3) 成人 200J 能量满足 <math>200J \pm 10\%</math> 要求；</li> <li>4) 当除颤分析仪输出不可电击心律时，设备正常发出“不建议电击”的语音提示。</li> </ol>

## 3、试验照片及数据



3#




4#




功能试验架设照片

1#

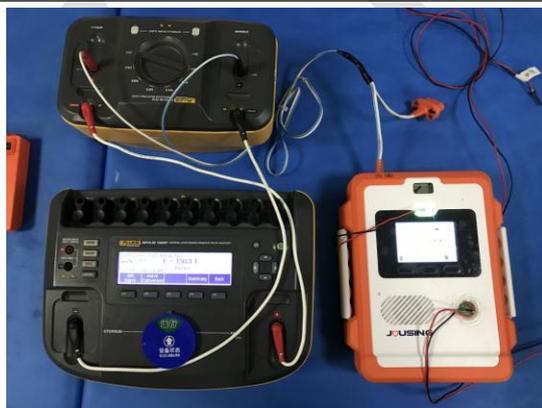


2#






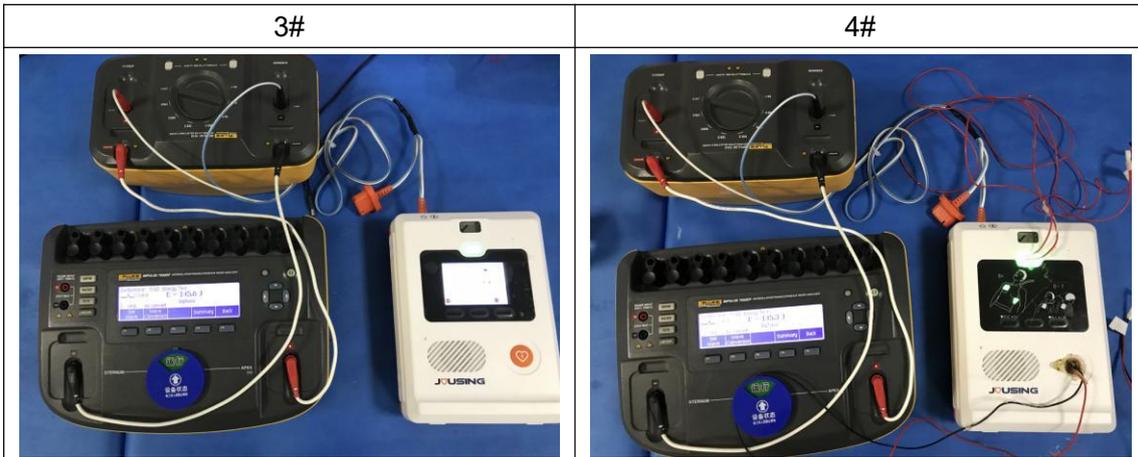


异丙醇擦拭试验前功能测试照片




1#

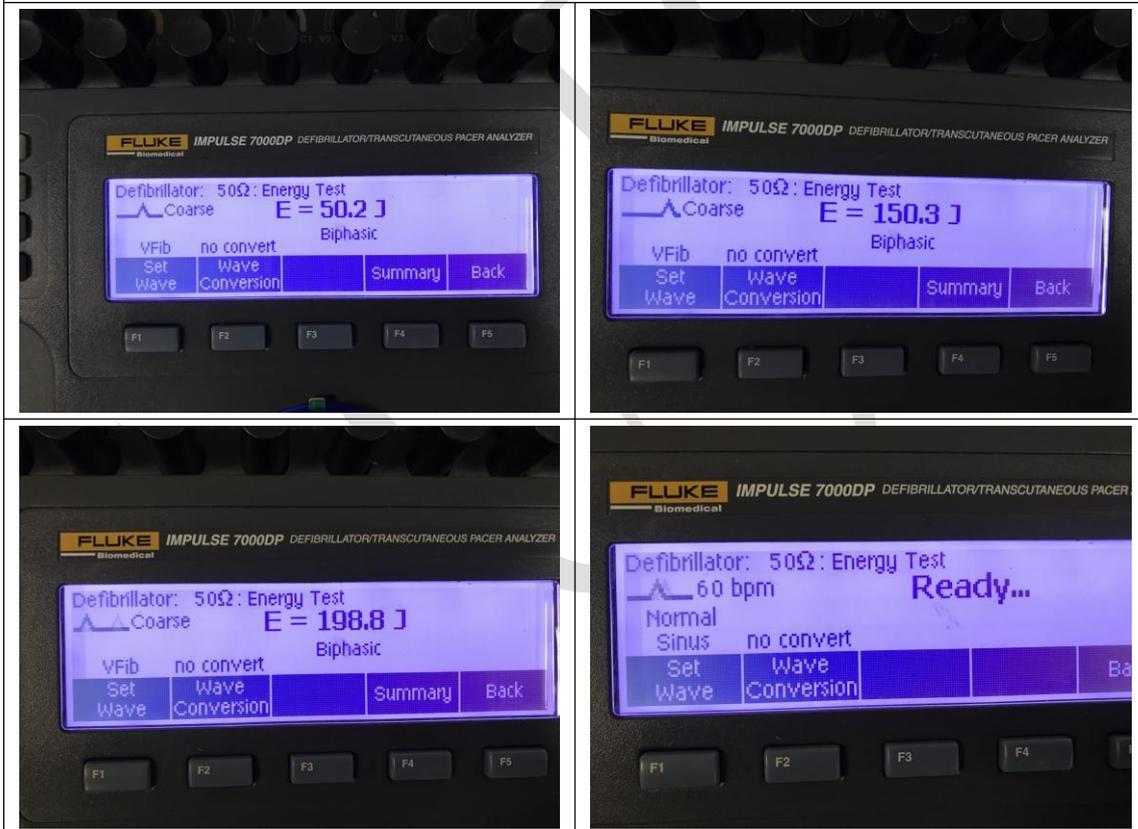

2#

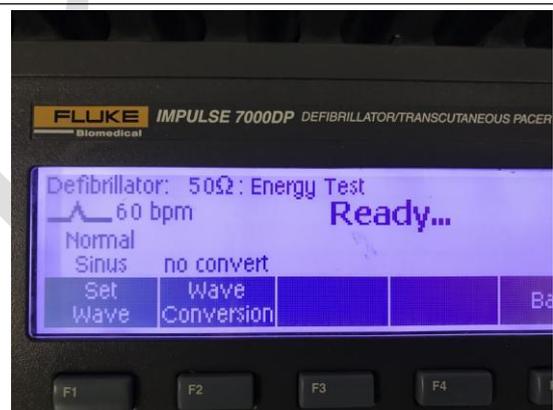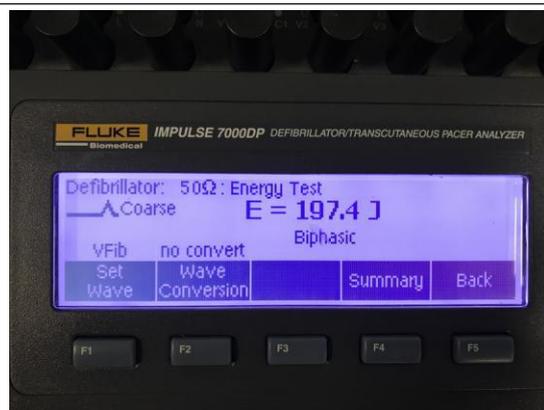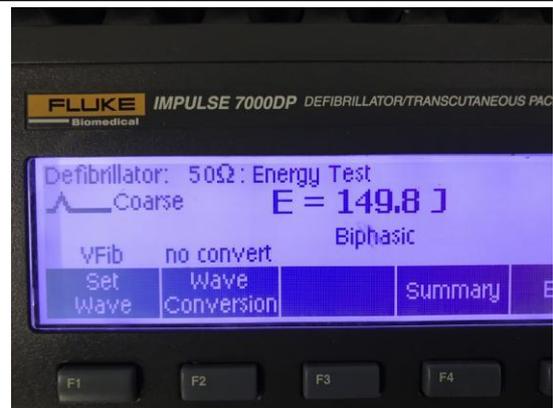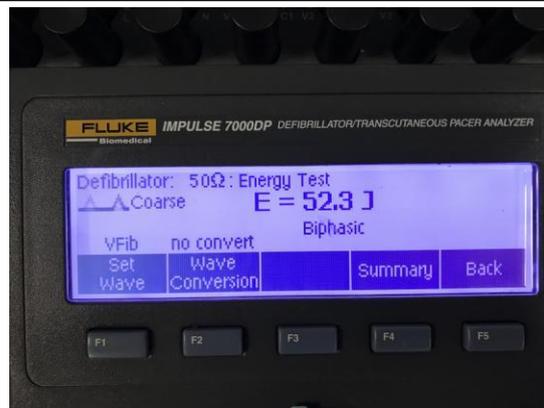

3#

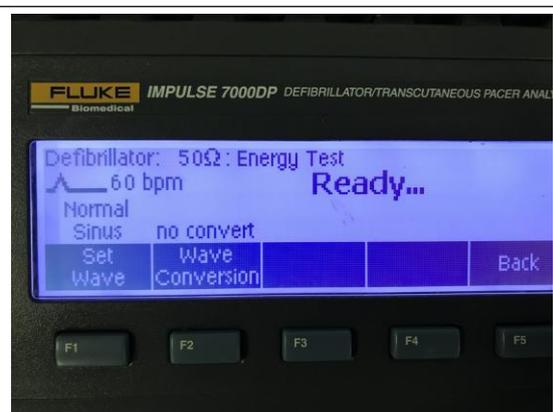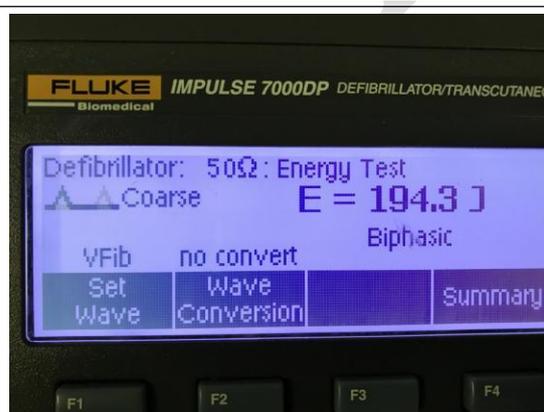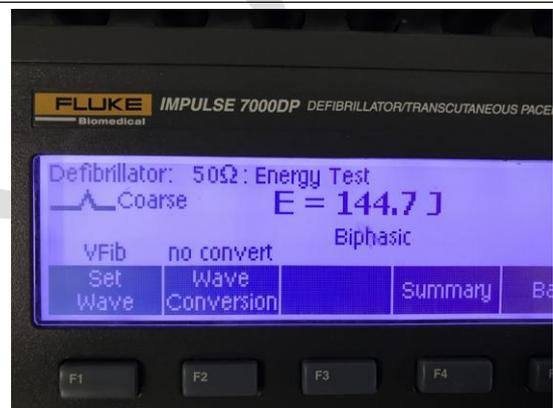

4#



异丙醇，酒精，过氧化氢溶液擦拭试验照片



异丙醇擦拭试验后功能测试照片

1#




2#



3#



4#

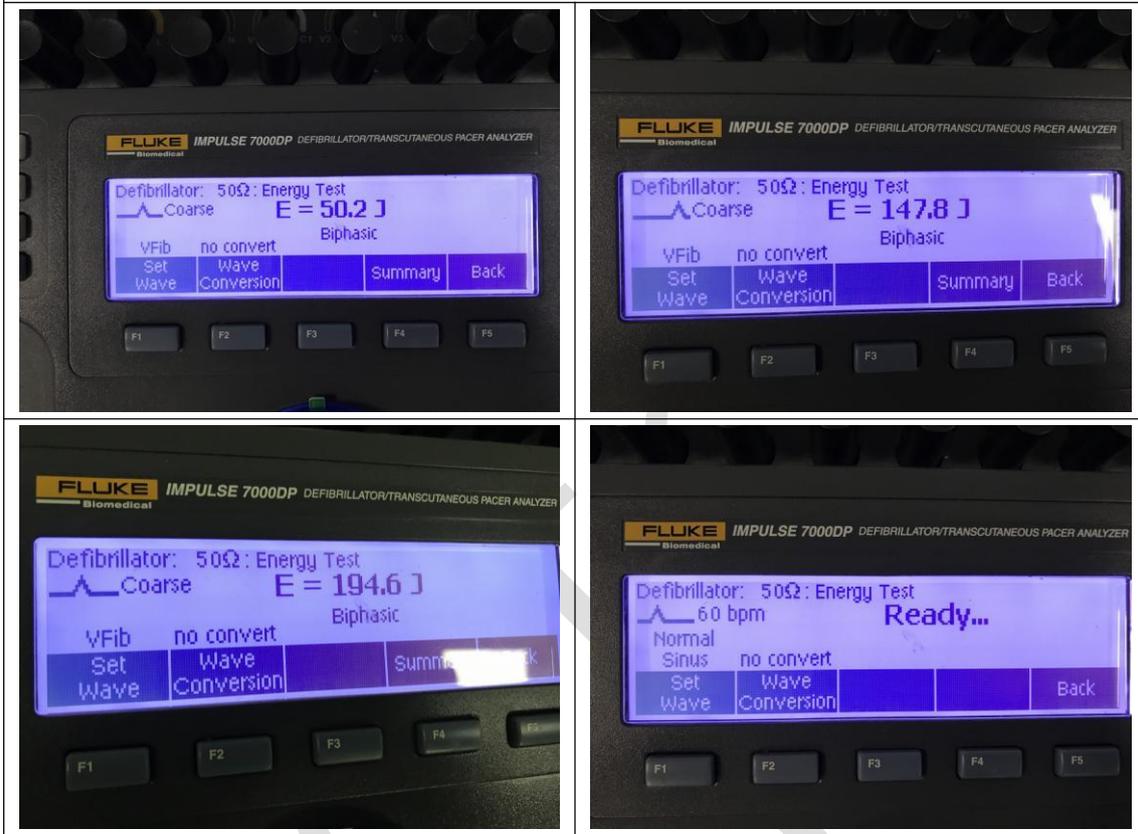

#### 4、试验溶液

序号	溶液名称	溶液浓度	生产日期	溶液有效期
1	异丙醇溶液	70%	2022.06.12	2024.06.13
2	酒精溶液	75%	2022.04.28	2024.04.27
3	过氧化氢溶液	2.5~3.5%	2022.07.22	2024.07.21

## 声 明

- 1、本实验室检测质量管理体系符合 CNAS-CL01: 2018 (等同于 ISO/IEC 17025:2017)的要求。经中国合格评定国家认可委员会 (CNAS) 评审并获得认可, 认可编号: CNAS L8212, 同时获得国际安全运输协会 (ISTA) 的认可, 认可编号: ISTA ID 10764;
- 2、本实验室对所有检测数据的公正性和客户 (委托单位) 信息的保密性负责, 除客户 (委托单位) 公开信息;
- 3、本实验室仅对客户 (委托单位) 委托检测项目负责;
- 4、本报告必须由审批人签字, 加盖本实验室检测专用章及骑缝章方为有效, 除全文复制外, 未经实验室批准不得部分复制报告;
- 5、所检测的样品均为客户 (委托单位) 送样, 本公司仅对本次送样的检测数据负责, 送样的真实性由客户 (委托单位) 承担;
- 6、对检验报告如有异议, 请在收到报告 15 天内向本单位书面提出;
- 7、受检样品务必在收到检测报告之后的三个月内领取, 逾期本实验室将自行处理;
- 8、分包方名称及分包项目详情: 无;
- 9、本次试验对样品的外观检查均为目测观察, 非目测观察的相关检测除外。
- 10、结论判定用语说明:
  - (1) 合格: 试验样品符合判定标准或客户 (委托单位) 判定要求;
  - (2) 不合格: 试验样品不符合标准或客户 (委托单位) 判定要求;
  - (3) /: 不作判定或没有判定标准或要求。
- 11、未加盖 CMA 标识的报告, 其出具的数据、结果仅供委托者了解样品品质之用。
- 12、本报告中的“委托检测合同单”未经过 CNAS 认可。
- 13、免责声明: 本报告的检测或判定结果仅对样品的外观判定负责, 如样品涉及性能或功能等方面的检测数据、结果及判定要求由客户 (委托单位) 提供, 本实验室对此不承担法律责任。

单位名称: 苏州冠测检测技术服务有限公司  
通信地址: 苏州市高新区鹿山路 369 号 (国家环保产业园 5 号楼东)  
办公电话: 0512-68326317  
传 真: 0512-69200365  
邮 箱: lcjc@szlcjc.com

\*\*\*报告结束\*\*\*